

ООО «Инновационные Медицинские Технологии»
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 48
ИНН 9204560720 КПП 920401001

Исх. № 1

«16» января 2018 г.

Контролирующему органу:

Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Свердловской области
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Московская, 11
Телефон/факс: (343)377-00-83/377-00-84
E-mail: to66@fas.gov.ru

Смирнов З.А.

*От работы
05
17.01.2018*

Заказчик: Публичное акционерное общество
«Машиностроительный завод имени
М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО
«МЗИК»)
Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург,
проспект Космонавтов, д.18
Адрес электронной почты:
zakupki_345@mail.ru, zakupki@zik.ru,
zik@mail.utk.ru
ФИО и номер контактного телефона:
Хасанов Александр Тахирович
Телефон: 7-343-3276065

Участник: Общество с ограниченной
ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН 9204560720
Юридический адрес: 299011, г.
Севастополь, ул. Ленина, д.48
Тел: 89781216373
Эл. Почта: imt-sevastopol@yandex.ru

№ закупки: 31705975966

ЖАЛОБА

на необоснованное включение требований в аукционную документацию, ограничивающих конкуренцию

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» сообщает, что ПАО «МЗИК» (далее по тексту – «Заказчик») на электронной торговой площадке в сети «Интернет» по адресу: <https://com.roseltorg.ru> 29.12.2017 г. было размещено извещение и документация о закупке, планируемой к проведению в форме открытого электронного аукциона на поставку комплекта автоклавов (далее по тексту – «Оборудование») (далее по тексту – «Аукцион»).

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 2 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее по тексту – «223-ФЗ»), при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, указанным Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 указанной статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Вх. № 01-634
«17» 01 2018
г. eo

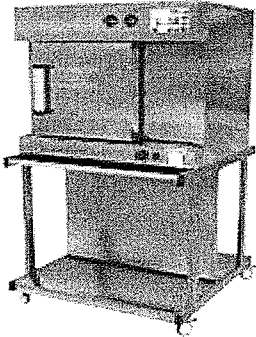
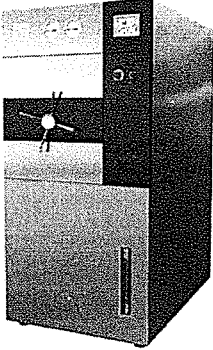

Сеть → Смирнов → Жалоба → ООО ММТТ

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

В соответствии с ч. 1, 5 ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Положения части 1 указанной статьи распространяются, в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Изучив документацию указанного Аукциона, ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» было выявлено, что требования к Оборудованию представлены Заказчиком показателями, характерными только для оборудования одного производителя. Подобное формирование документации значительно ограничивает количество предлагаемого к поставке оборудования и участников, которые имеют возможность поставить необходимое Заказчику Оборудование. Совокупность всех параметров характерна только для Автоклава Cliniclave 45 (Melag), Германия.

Между тем, автоклав, как Оборудование, производится несколькими производителями (в том числе отечественными) и может быть представлено в нескольких вариантах исполнения (моделях). Наиболее близкими по характеристикам, изложенным в документации Аукциона являются:

Характеристика	PHS-100 (ТЗМОИ)	ГК-100-4 (ТЗМОИ)	Cliniclave 45 (Melag)	Комментарий
Фото				
Страна происхождения	РФ	РФ	Германия	
Гарантия	1 год	1 год	1 год	
Форма камеры	прямоугольная	круглая	круглая	Прямоугольная форма камеры гарантирует полноценное и более эффективное использование внутреннего пространства, а также обеспечивает большую загрузку.
Габариты камеры (глубина*ширина*высота)	650*400*400	830*400 (Ø)	720*440 (Ø)	

Объем(л)	100	100	105	За счёт того, что форма камеры Cliniclave 45 круглая, происходит значительная потеря полезного объёма.
Кол-во программ	15	7	7	Большее количество программ позволяет выбрать индивидуальную программу в соответствии с обрабатываемым инструментом
Свободно программируемый режим	наличие	наличие	нет	Свободный режим может быть выбран под потребности заказчика
Программа для стерилизации растворов	наличие	наличие	нет	Стерилизатор PHS помимо стандартных программ стерилизации может быть использован и для стерилизации растворов
Тестовые программы	наличие	наличие	наличие	
Тип двери	Слайдовая сдвижная дверь	Сейфовая дверь	Сейфовая дверь	Слайдовая сдвижная дверь экономит пространство в зоне загрузки стерилизатора
Документирование параметров стерилизации	встроенный принтер	встроенный принтер	Документирование цикла через встроенный порт для подключения к принтеру или компьютеру. Принтер дополнительно, отдельно стоящее устройство, которое требует отдельного места для установки.	Встроенный принтер в стерилизаторе PHS – обеспечивает наличие у заказчика постоянного отчета о пройденном цикле
Русифицированный Touch Screen дисплей для отображения параметров стерилизации и управления	Цветной, сенсорный экран с размером диагонали 17,78 см	Цветной, сенсорный экран с размером диагонали 17,78 см	Цветной, сенсорный экран с размером диагонали около 12 см	Большой цветной дисплей в стерилизаторе PHS обеспечивает комфорт эксплуатации для оператора, а также обеспечивает лучшую наглядность и исключает вероятность ошибки.

Диапазон температур	102-135	102-135	121-134	Более широкий диапазон температур позволяет задать нужный режим для того или иного инструмента
Потребляемая мощность, кВт	8	11	10,5	В стерилизаторах PHS-100 экономичное потребление электроэнергии.

Таким образом, ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» считает, что формулировка документации Аукциона Заказчиком противоречит положениям ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ и ограничивает предложения потенциальных участников до поставки только Автоклава Cliniclave 45 (Melag), Германия.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом о контрактной системе

ПРОШУ:

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу.
2. Выдать предписание об устранении нарушений, путем внесения изменений в документацию об аукционе в электронной форме под реестровым номером № 31705975966.

Приложение:

1. Документация аукциона.
2. Копия свидетельства о регистрации.
3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.

Генеральный директор

Подписано ЭЦП

Давлетшина Л.З.