

**В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Кемеровской области**

Адрес: ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000

Единый телефон управления: (3842) 36-42-28

Факс: (3842) 36-77-83

E-mail: to42@fas.gov.ru

Податель жалобы: **Общество с ограниченной ответственностью**
«ПраймГрупп»
(ОГРН 1117847355933)
196084, Санкт-Петербург, проспект Московский,
дом 111, Литер А, помещение 12Н, офис 518
адрес электронной почты:
primegroupmed@gmail.com
телефон: 8(931)985-69-55
Генеральный директор Наумов В.С.

Жалоба
на положение документации об электронном аукционе
(извещение № 31908530607)

Наименование заказчика	Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1».
Контактная информация	Место нахождения /Почтовый адрес: 654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 28.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Открытый аукцион в электронной форме
Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке	www.zakupki.gov.ru
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ЭТП "ОТС.ru"
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://otc.ru
Номер извещения о проведении электронного аукциона	31908530607
Наименование объекта закупки	Поставка медицинских изделий
Дата и время начала подачи заявок	18.11.2019 (МСК+4)
Дата и время окончания подачи заявок	04.12.2019 в 08:00 (МСК+4)
Начальная (максимальная) цена контракта	48 168 184,60 руб.

Доводы жалобы.

Заявитель считает, что документация не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе по следующим основаниям:

1. Необъективное описание объекта закупки нарушает антимонопольное законодательство и приводит к ограничению числа участников торгов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона № 135-ФЗ под товаром понимается объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Согласно пункту 3 статьи 4 Закона № 135-ФЗ под взаимозаменяемыми товарами понимаются товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях).

В силу части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

При этом если организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются такими принципами, как: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки и отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Однако, Заказчиком были установлены уникальные технические характеристики, ограничивающие участие в закупке единственным производителем.

Совокупность требуемых параметров к закупаемому товару по позиции 19 «Стент коронарный» технического задания, сформулированы без возможности поставки эквивалента в связи с отсутствием параметров эквивалентности, такие требования приводят к ограничению числа участников закупок, и, как следствие, устранению конкуренции при осуществлении закупок.

Таким образом, требования, установленные в описании объекта закупки составлены с учетом ограничения единственным товаром - коронарным стентом Desyne, производителя Elixir, США:

А именно:

Материал стента: немагнитный кобальт-хромовый сплав.

Дизайн ячейки – открытая. 8-лучевая структура для диаметров 3,0; 3,5; 4,0мм и 6-лучевая структура для диаметров 2,5; 2,75 мм.

Тип баллона (Система доставки): Монорельсовый (Быстрая замена).

Общая рабочая длина системы доставки не менее 120 см и не более 140 см. Совместим с проводником 0.014" и проводниковыми катетерами 5Fr. Наличие 2 рентгенконтрастных маркеров, интегрированных в shaft. Номинальное давление 8-10 атм, расчетное давление разрыва не более 16 атм. Стент содержит препарат Новолимус (активный метаболит Сиролимуса). Препарат высвобождается из прочного метакрилатного полимера (полимер нанесен без праймеров, толщина поли-мерного покрытия не более 3 микрон).

Доступные диаметры: 2,5мм; 2,75мм; 3,0мм; 3,5мм; 4,0мм.


Длины: 14мм, 18мм, 23мм, 28мм; 32мм; 38мм.

На фото из каталога производителя представлена информация тех параметров коронарных стентов Desyne, производителя Elixir:

DESyne® NOVOLIMUS™ Eluting Coronary Stent System

The Path to Next Generation Drug-Eluting Stent Technology Engineered to Maximize Deliverability and Clinical Performance.

Introducing the Novolimus-eluting DESyne stent the next generation drug eluting stent with improved performance and superior clinical efficacy and safety¹. Engineered on a clinically- proven cobalt chromium platform, the novel design and Formula X™ drug/polymer coating technology allows for thin struts, lowest polymer load², and lowest drug concentration² of any DES on the market today. DESyne[®] maximizes deliverability and is able to deliver superior performance with the lowest published late lumen loss⁴.

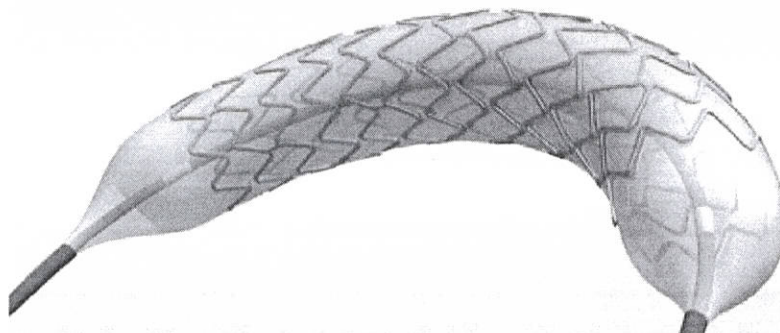

PRODUCT ORDERING INFORMATION						
Stent Diameter (mm)	Stent Length (mm)					
	14	18	23	28	32	38
2.5	SER2514	SER2518	SER2523	SER2528	SER2532	SER2538
2.75	SER2714	SER2718	SER2723	SER2728	SER2732	SER2738
3.0	SER3014	SER3018	SER3023	SER3028	SER3032	SER3038
3.5	SER3514	SER3518	SER3523	SER3528	SER3532	SER3538
4.0	SER4014	SER4018	SER4023	SER4028	SER4032	SER4038

Some sizes may not be available in all geographies.

Так как в Российской Федерации зарегистрировано только одно медицинское изделие – стент коронарный с лекарственным веществом Новолимус (Desyne, производителя Elixir, США), то ни одно другое медицинское изделие не могло бы удовлетворить всем условиям описания объекта закупки в пункте 19 технического задания.

Следовательно, заказчиком установлены параметры, которые не обуславливают его потребность, однако делают невозможным предложить к поставке аналогичные или эквивалентные товары иных производителей.

Также просим устранить несоответствия в техническом задании связанные с неоднозначной формулировкой необходимого Заказчику количества медицинских изделий, поскольку :

- Потенциальный участник электронного аукциона не располагает точными данными, какое количество медицинских изделий (определенного размера) необходимо Заказчику.

Для примера , приводим п.б. технического задания

1	32.50.13.190	Проводник коронарный	набор	760	Проводник выполнен из высокоэластичного сплава на основе нитинола. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия всего проводника. Диаметр: 0.018", 0,020", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Длина: не более 180 см. Жесткость: стандартный, жесткий, полужесткий. Кончик: в диапазоне от 10 до 80 мм. Форма кончика: под углом 45 градусов, прямой, j-тип, с формируемой формой, два изгиба.
---	--------------	----------------------	-------	-----	---

Исходя из этого, участник должен располагать Проводниками коронарными диаметрами:

0.018" - в количестве 760 шт., 0,020" - в количестве 760 шт, 0.025" - в количестве 760 шт, 0.032"- в количестве 760 шт, 0.035"- в количестве 760 шт, 0.038"- в количестве 760 шт.

По мнению заявителя, подобный вариант исполнения ТЗ не является допустимым, поскольку участник должен располагать огромными запасами вышеуказанных мед. изделий, - что явно ограничивает круг потенциальных участников, так как необходимыми запасами располагают исключительно крупные дистрибьюторы.

Далее того, срок поставки по условиям Контракта составляет всего «5 (пять) дней с момента получения заявки Заказчика», - очевидны преимущества для местных (Кемеровская область) поставщиков находящихся в заведомо более выгодных условиях по отношению к другим участникам на территории РФ.

На основании изложенного, и в целях недопущения нарушения законодательства при осуществлении закупки, а также в соответствии со ст.17 Федерального закона 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 2 ч. 10 ст. 3 Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРОШУ:

- 1) признать положения документации на право заключения государственного контракта на поставку медицинских изделий №31908530607 не соответствующим действующему законодательству в сфере закупок;
- 2) обязать Заказчика внести соответствующие изменения в положения документации на право заключения государственного контракта на поставку медицинских изделий №31908530607
- 3) приостановить определение поставщика до рассмотрения настоящей жалобы, по существу.

Генеральный директор

ООО «ПраймГрупп» _____ Наумов В.С.

